L'élaboration de la barre d'ancrage:
PRECI-HORIX

1. Utilisez la barre profilée en PLASTICWAX pour couler les coiffes à tenon radiculaire et la barre dans le même alliage. Ne pas plier ni déformer. Positionner sur le même plan qu'un axe de rotation éventuel.

2. Préparation pour la coulée en une pièce. La barre en plastique calcinable peut également être ajustée sans contact direct avec la gencive.

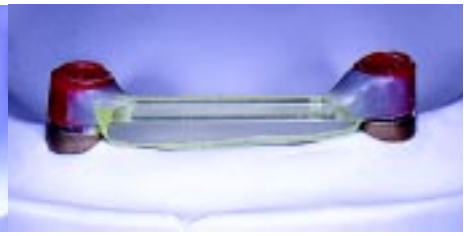

3. Un champ d'application actuel est certainement la prothèse implantaire.

4. Les tiges de coulée sont positionnées en dehors de la zone fonctionnelle de la barre.

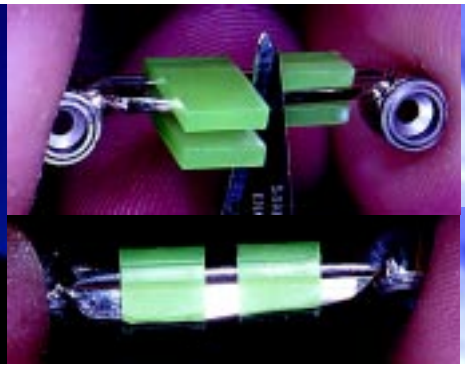

5. Les cavaliers de travail en plastique seront raccourcis et positionnés sur la barre pour permettre le positionnement des cavaliers flexibles.

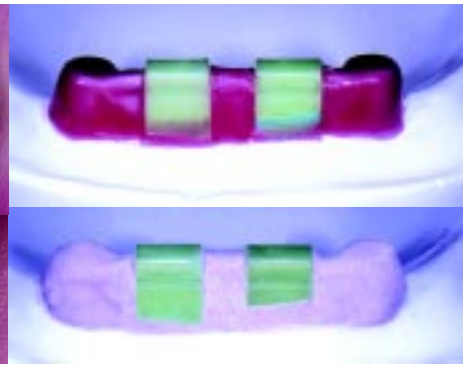

6-7. L'apport de la cire de dépouille pour la technique de duplicata ou de plâtre pour la polymérisation directe sur le modèle initial.

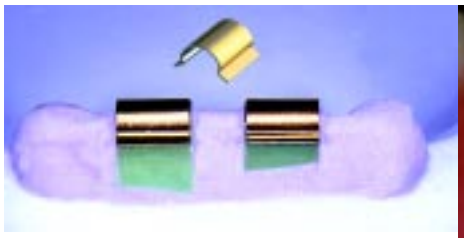

8. La polymérisation d'une logette flexible en acier inoxydable jaune-or garantit le positionnement parfait du cavalier plastique.

9. Cette coupe montre clairement la fonction de la logette.

10. Trois cavaliers plastiques pour déterminer le degré de rétention souhaité de la prothèse (jaune = normal, blanc = réduit, rouge = accru). Le cavalier pourra toujours être remplacé!